M2720A Avalon CTS Bezdrôtový systém snímania plodu

Výstrahy a činnosť používateľa

Výstrahy základňovej stanice:

bliká, samostatne alebo spoločne s kontrolkami na ľavej alebo pravej strane. označuje, že kontrolka nesvieti alebo svieti nepretržite.

označuje akustické upozornenie, ak je nastavené. Stlačte C pre vypnutie zvukovej indikácie.

Výstrahy snímača:

bliká spoločne so symbolom predstavujúcim zdroj problému.

Ak bude generovaná táto výstraha…		…Vykonajte toto…
…Na základňovej stanici…	…Na snímači...	
		Vložte snímač pre dobíjanie akumulátora alebo použite iný snímač s nabitým akumulátorom. Ak 30 minút po výmene problém stále pretrváva, vymeňte akumulátor snímača. (Pozri *servisná príručka*.)
		Skontrolujte, či je snímač aktívny a nachádza sa v dosahu príjmu. Skontrolujte pripojenie antény.
		Stlačte C na dobu 2 sekúnd pre uvoľnenie zablokovaného slotu.
Príklad označenia lôžka		Tento slot už má **aktívny** snímač (v tomto príklade je označenie lôžka 38). *Buď* vložte najprv tento snímač, aby bol slot dostupný *Alebo*, ak je na snímači zobrazené označenie lôžka (v tomto príklade 16), vráťte ho do jeho základňovej stanice.
Príklad označenia lôžka	Príklad označenia lôžka	
		Obráťte sa na poskytovateľa servisných služieb (snímač sa nemôže zaregistrovať).
		Ak je aktívny snímač EKG, pripojte kábel. Vložte snímač do slotu podľa pozície indikovanej bodom (snímač je v nesprávnom slote).
Chybové správy základňovej stanice a snímača (E0 až E9): Pozri *návod na obsluhu*		

© 1995-2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.
Vytlačené v Nemecku, apríl 2006
Číslo M2720-9051B
4512 610 15081

Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
Hewlett-Packard-Str.2
71034 Boeblingen, Nemecko

PHILIPS

M2720A Avalon CTS Bezdrôtový systém snímania plodu
Stručné pokyny

1 110 – 240 V str.



2 Zapnite

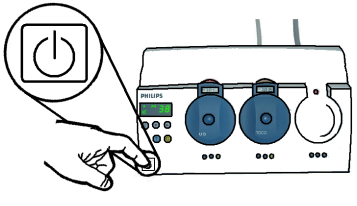

3

TELE

Skontrolujte, či sa na fetálnom monitore zobrazilo "TELE" indikujúce dobré spojenie so systémom Avalon CTS

4 Vyčkajte, až sa rozsvieti kontrolka „pripravené"



5 Vyberte snímač



Kontrolka „pripravené" zhasne: rozsvieti sa kontrolka „vysokofrekv. spojenie"



6 Aplikujte snímač (pre ultrazvukový snímač použite gél)

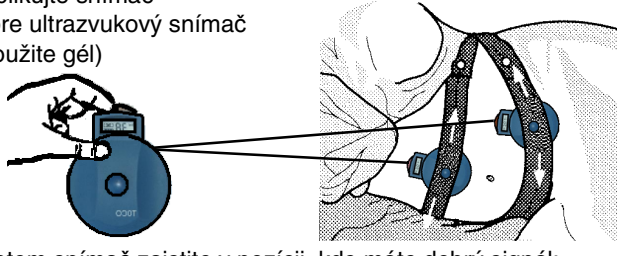

Potom snímač zaistite v pozícii, kde máte dobrý signál:

monitory Avalon

monitory série 50

Prechod od ultrazvuku k monitorovaniu DECG	
1	Zapojte (vložte) ultrazvukový snímač.
2	Vyberte von snímač EKG, keď bude kontrolka daného slotu svietiť zeleno.
3	Pripojte prechodový kábel DECG a skalpovú elektródu ku snímaču EKG.
4	Zahájte monitorovanie DECG.

Prechod od DECG k monitorovaniu ultrazvukom	
1	Odpojte prechodový kábel DECG a skalpovú elektródu od snímača EKG.
2	Zapojte (vložte) snímač EKG.
3	Vyberte von ultrazvukový snímač, keď bude kontrolka daného slotu svietiť zeleno.
4	Zahájte monitorovanie ultrazvukom.

Pred použitím systému Avalon CTS odpojte od monitora všetky káblom pripojené elektródy.

Dva aktívne snímače vysielajúce srdcovú frekvenciu plodu do rovnakej základňovej stanice zavinia výskyt chybovej správy **E9**. Pre vymazanie tejto správy vložte jeden zo snímačov do slotu.

Po použití: Očistite snímače. Potom ich vložte do príslušných slotov základňovej stanice.